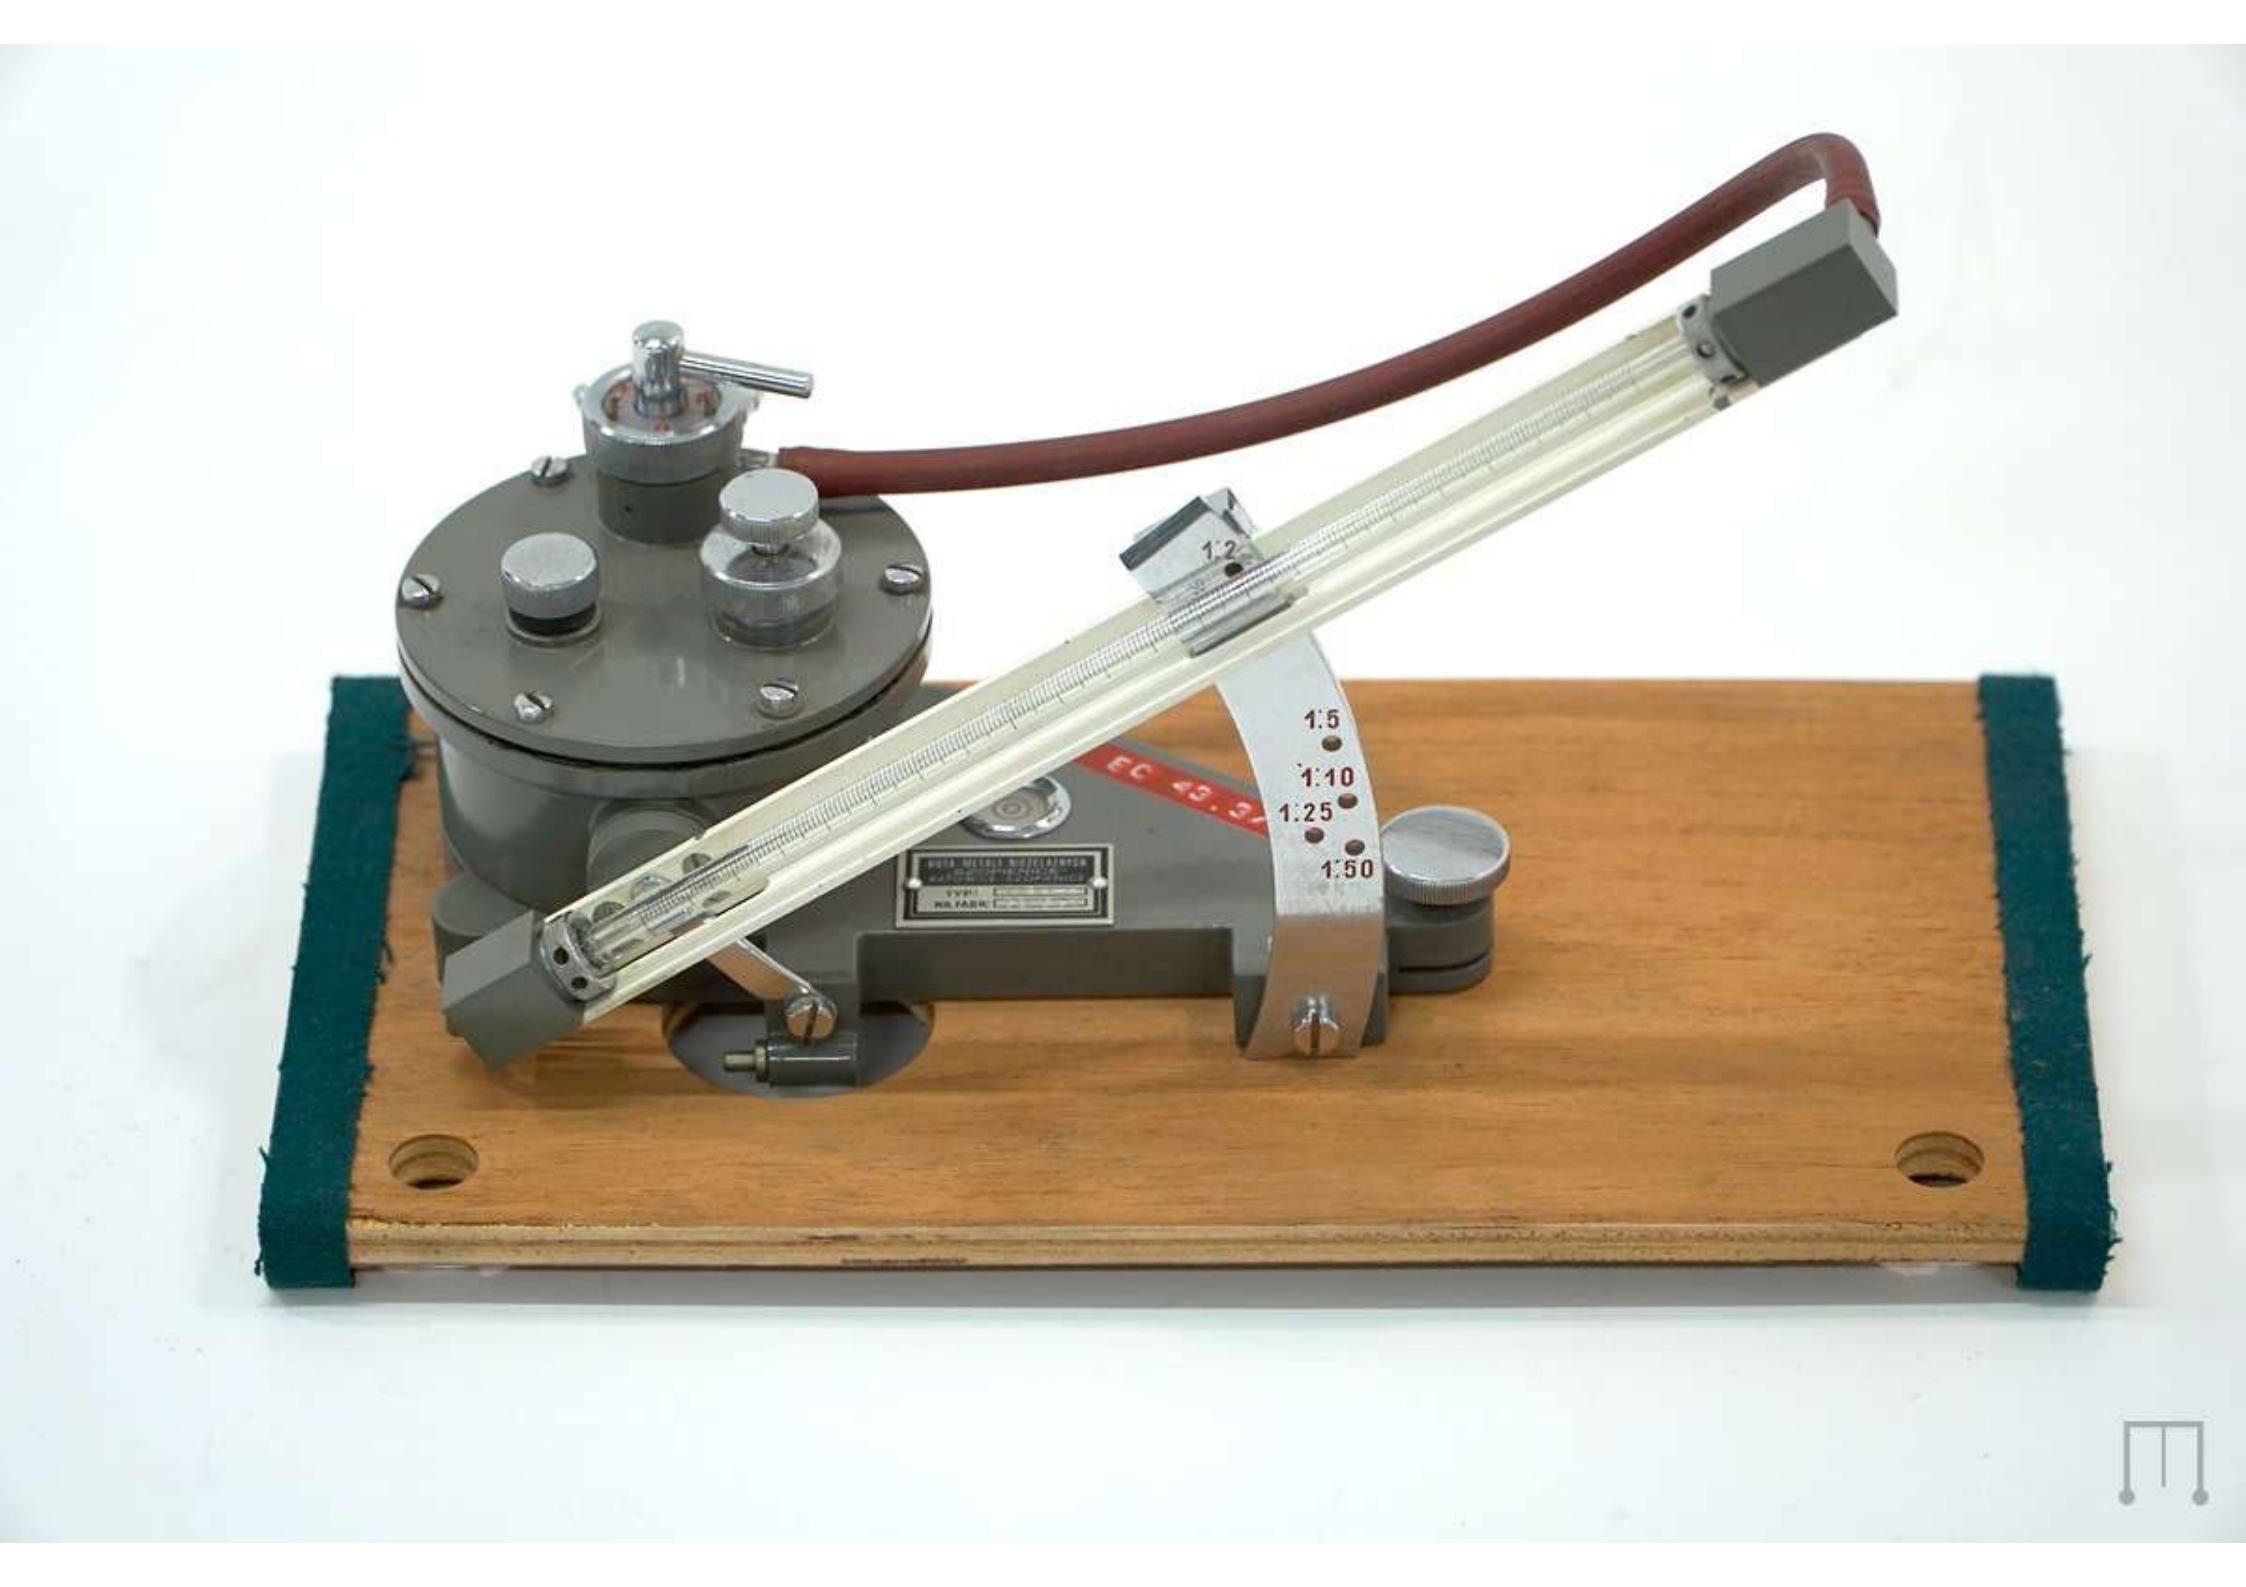



SPÓŁDZIELNIA PRACY
AREOMETR
W WARSZAWIE
PSYCHROMETR A2
◄ts
tw ►
WILGOTNOŚĆ POWIETRZA
temp. powietrza -ts w °C
Różnica temperatur ts–tw
1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
0 80 60 51 41 32 22 13 4
2 82 64 55 47 38 30 21 13 5
4 84 67 59 51 44 36 29 21 14 6
6 85 70 63 56 48 41 35 28 21 14 8
8 86 72 66 59 53 46 40 34 27 21 15 6
10 87 74 68 62 56 50 44 39 33 27 22 16 11 6
12 88 76 70 65 59 54 48 43 38 33 28 23 18 13
14 89 78 72 67 62 57 52 47 42 37 32 28 23 19
16 89 79 74 69 64 60 55 50 46 41 37 33 28 24
18 90 80 76 71 66 62 58 53 49 45 41 37 33 29
20 91 81 77 73 68 64 60 56 52 48 44 40 37 33
22 91 82 78 74 70 66 62 58 54 51 47 43 40 36
24 91 83 79 75 71 68 64 60 57 53 50 46 43 40
26 92 84 80 76 73 69 66 61 59 55 52 49 46 42
28 92 84 81 77 74 71 67 64 60 57 54 51 48 45
30 93 85 82 78 75 72 68 65 62 59 56 53 50 47
32 83 79 76 73 70 67 64 61 58 55 52 49
34 71 68 65 62 59 57 54 51



Manometer
für Feinmessungen
41 5 kN = 40 MPa
Nr. 2


1:2
1:5
1:10
1:25
1:50


BAROGRAF TYGODNIOWY
Sobota
Niedziela


300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
290
270
250
230
210
190
170
150
130
110
90
70
50
30
10



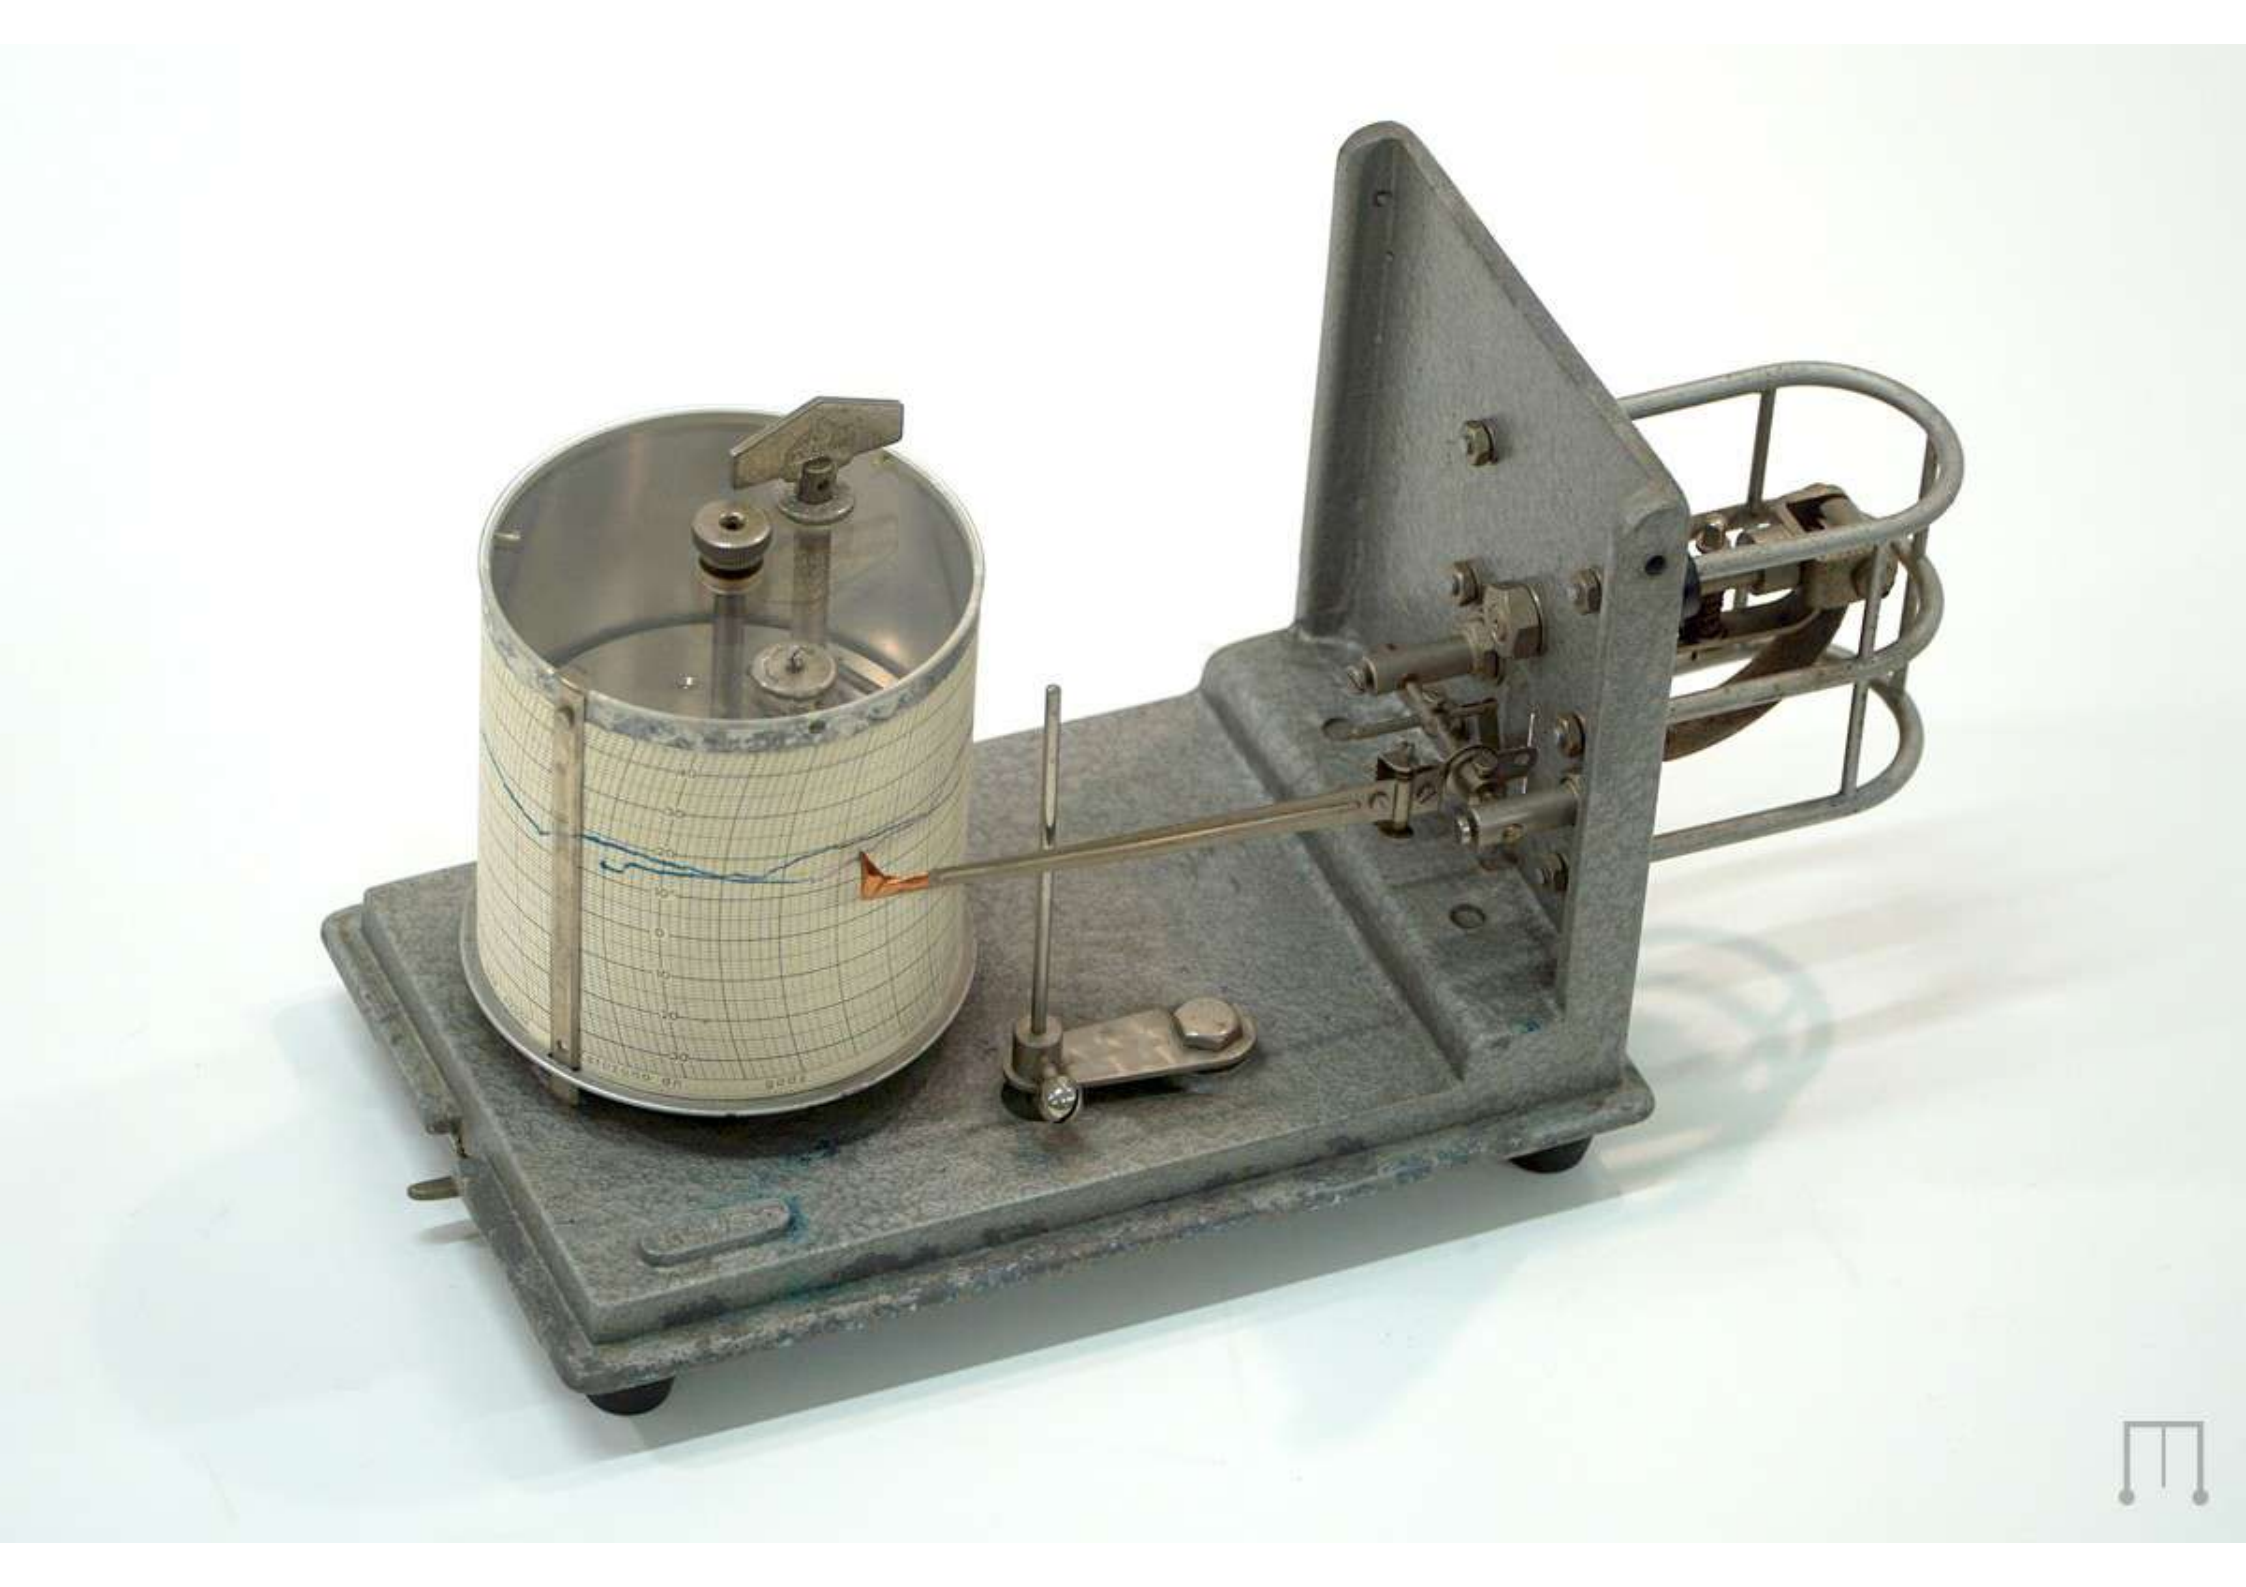



I.R.RADIATION METER
TYPE-WRM NO
KONIEC
POMIARU
μA
MEA-1
1973
ZAKRESY:
BAT.
ZERO
POMIAR
1
2
3
MACIEJ L.WEINER
BYDGOSZCZ
POLAND



PL-PD-2626
PRZEŁĄCZNIK ZAKRESÓW
WYŁ.
500
1000
0
5
10
15
20
25
µA
NFe
MEA-4
SKALOWANIE ZAKRESÓW
1000
500
FOTODIODA FG-2
LUKSOMIERZ Z FOTODIODĄ FG-2


OPTICAL POWER METER type MS – 3B
dBu
dBm
CAL
OP
dBu
dBm
AC
DC
ON
OFF
OPTICAL POWER TRANSMITTER
type NMO-2
OPEN
ON
OFF


CALOMEL ELECTR.
GLASS ELECTR.
ASYMM. POTENTIAL
PHILIPS
PH METER GM4494
OFF
CAL
PH
-mV
PRESS
°C
TEMPERATURE
x100mV

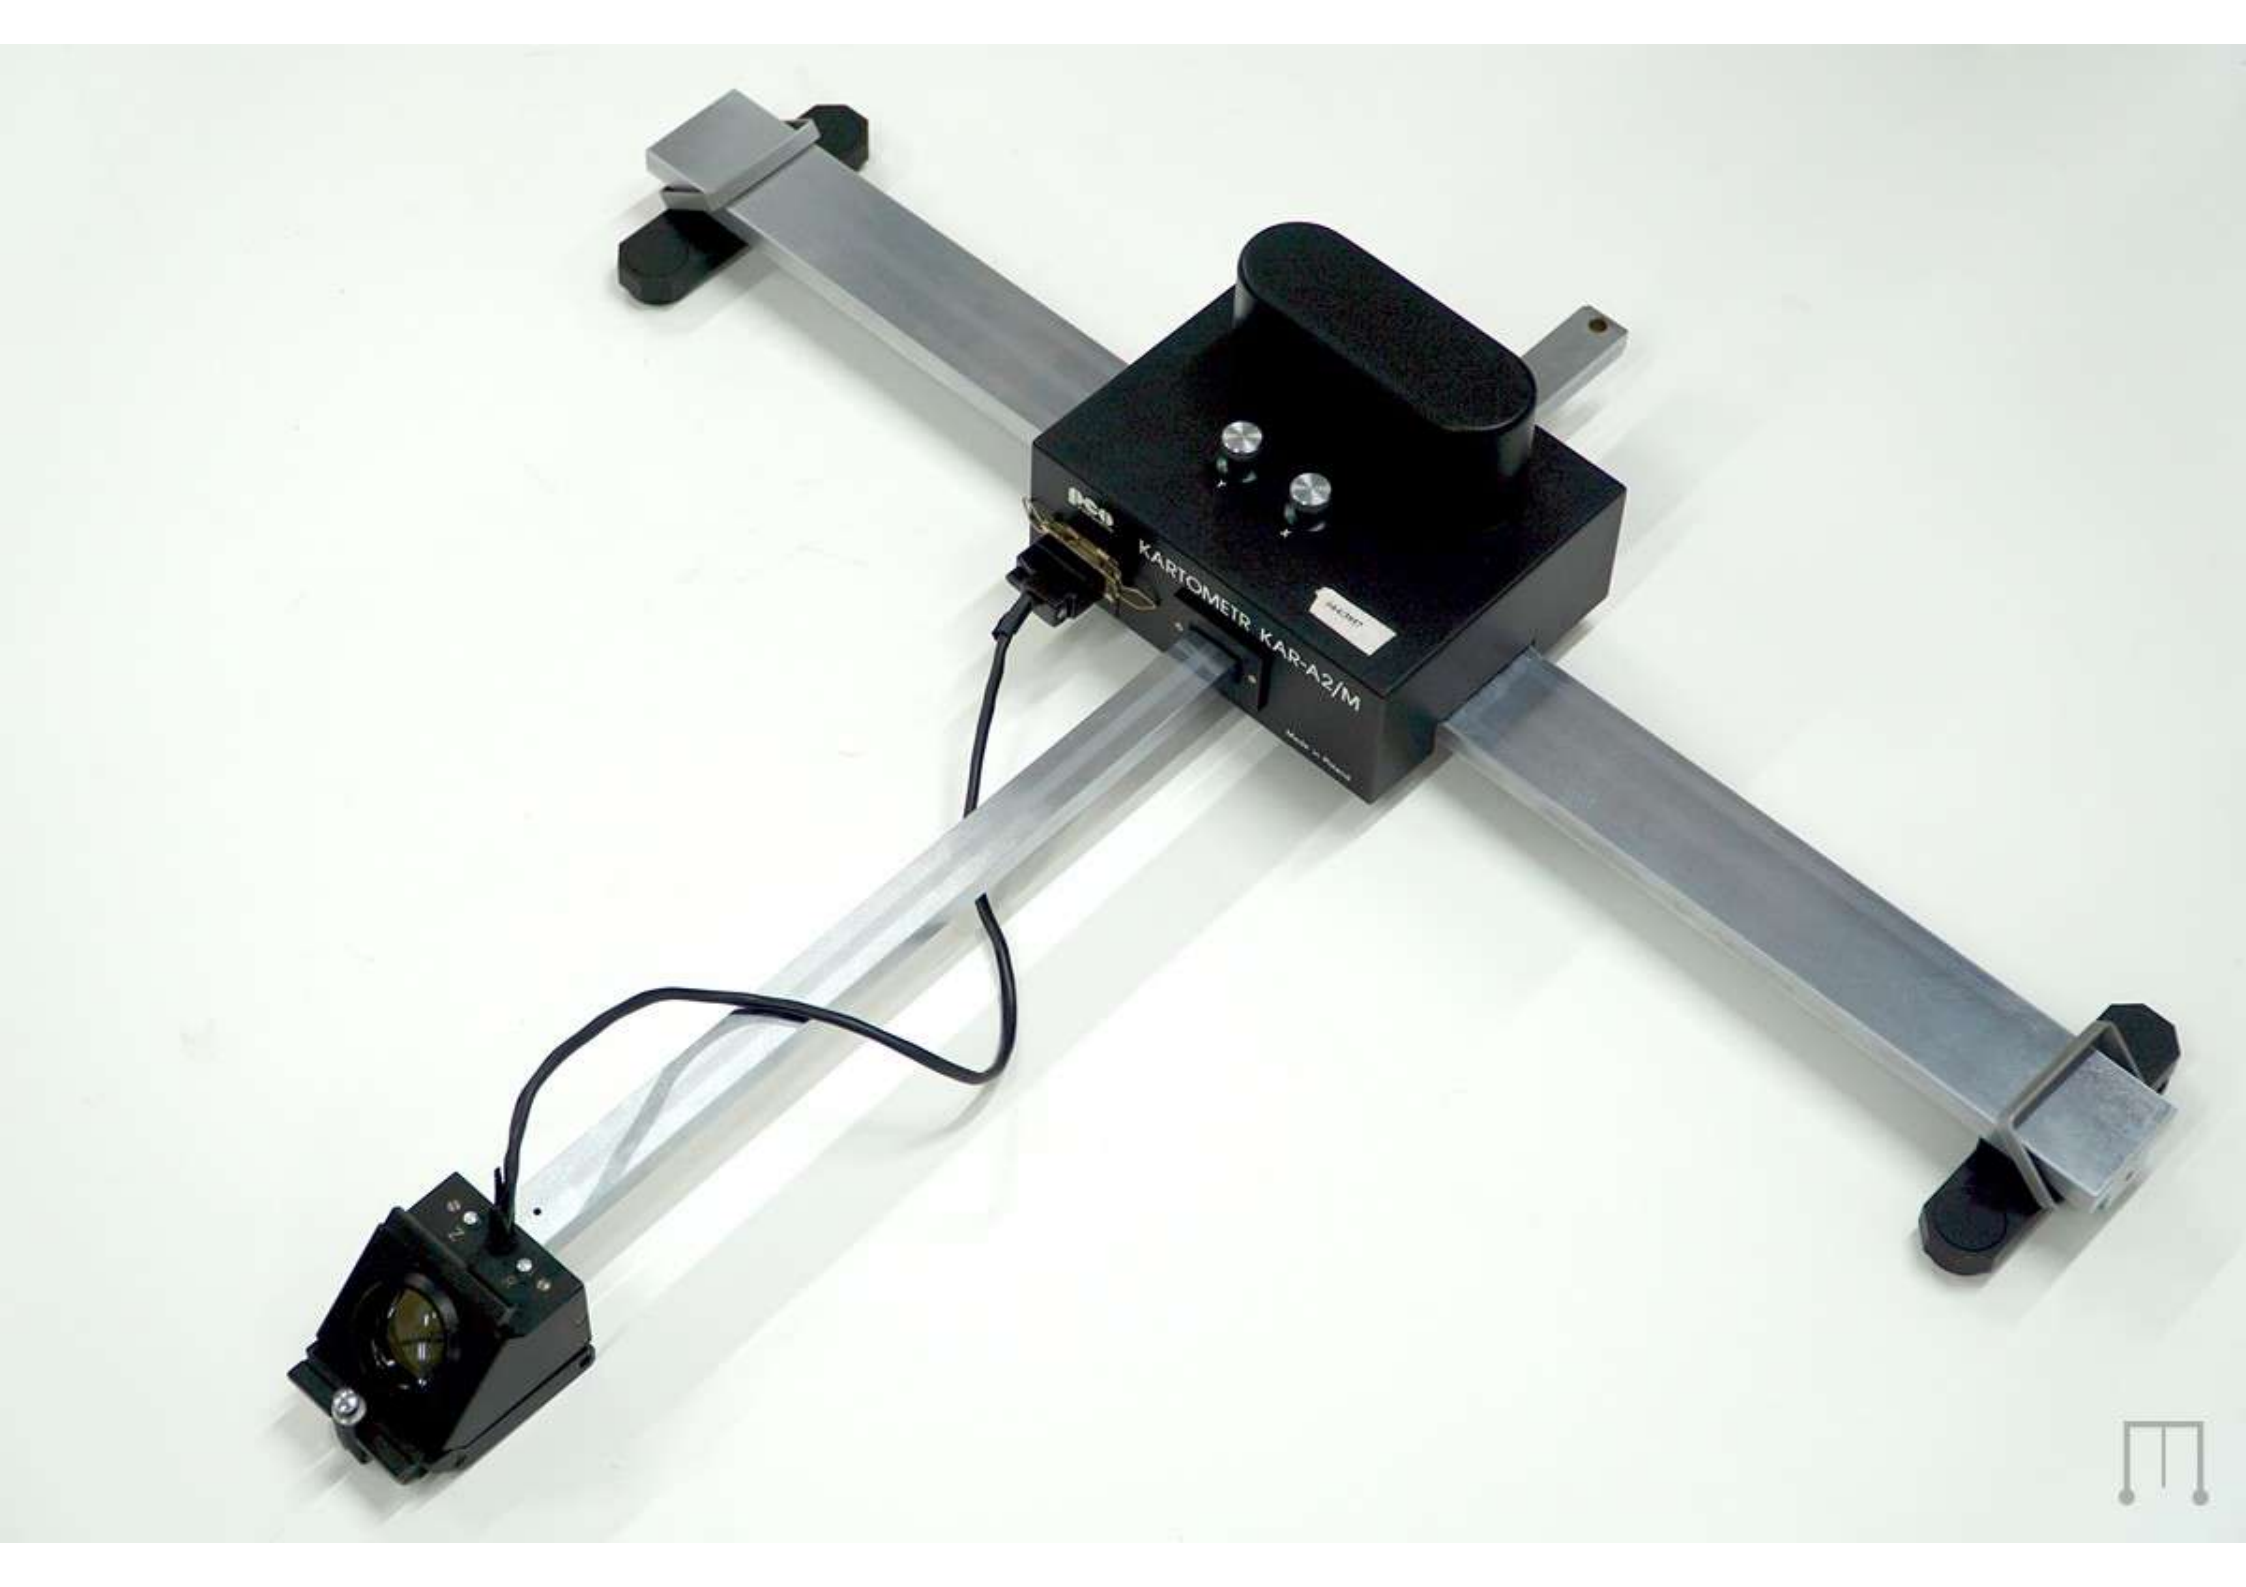
KARTOMETR KAR-A2/M


8749
Made in Poland

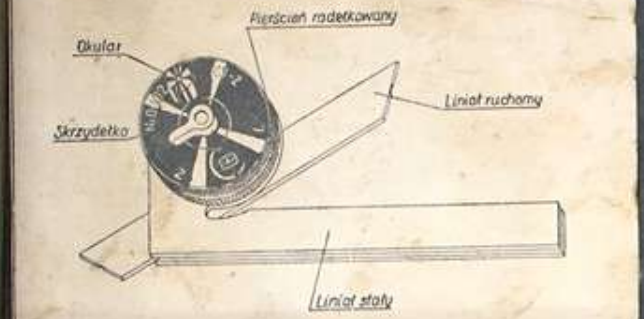


PZO

## Uniwersalny kątomierz optyczny
## Sposób użycia:

Skrzydełko służy do zaciskania liniału ruchomego.
Pierścień radełkowany służy do zaciskania obrotu.

Skrzydełko, które zwykle powinno być ustawione na „Z" ustawić na „L". Wysunąć liniał ruchomy na żądaną długość i przestawić skrzydełko na „Z".

Pierścień radełkowany obrócić w lewo i nastawić żądany kąt, lub dopasować krawędzie liniału ruchomego i liniału stałego do przedmiotu mierzonego. Ustalić dane położenie obrotem pierścienia w prawo.

Kąt w stopniach i minutach odczytuje się przez lupę na kręgu szklanym. Do odczytu należy skierować otwór z filtrem w stronę największego nasilenia światła, a oko przybliżyć do lupy.


Nie należy: nastawiać kąta przy skrzydełku ustawionym na „L"
wkładać do futerału kątomierza ze skrzydełkiem ustawionym na „L"
przesuwać liniału ruchomego przy skrzydełku ustawionym na „Z"







0.01мм
ГОСТ 577-68
Made in USSR




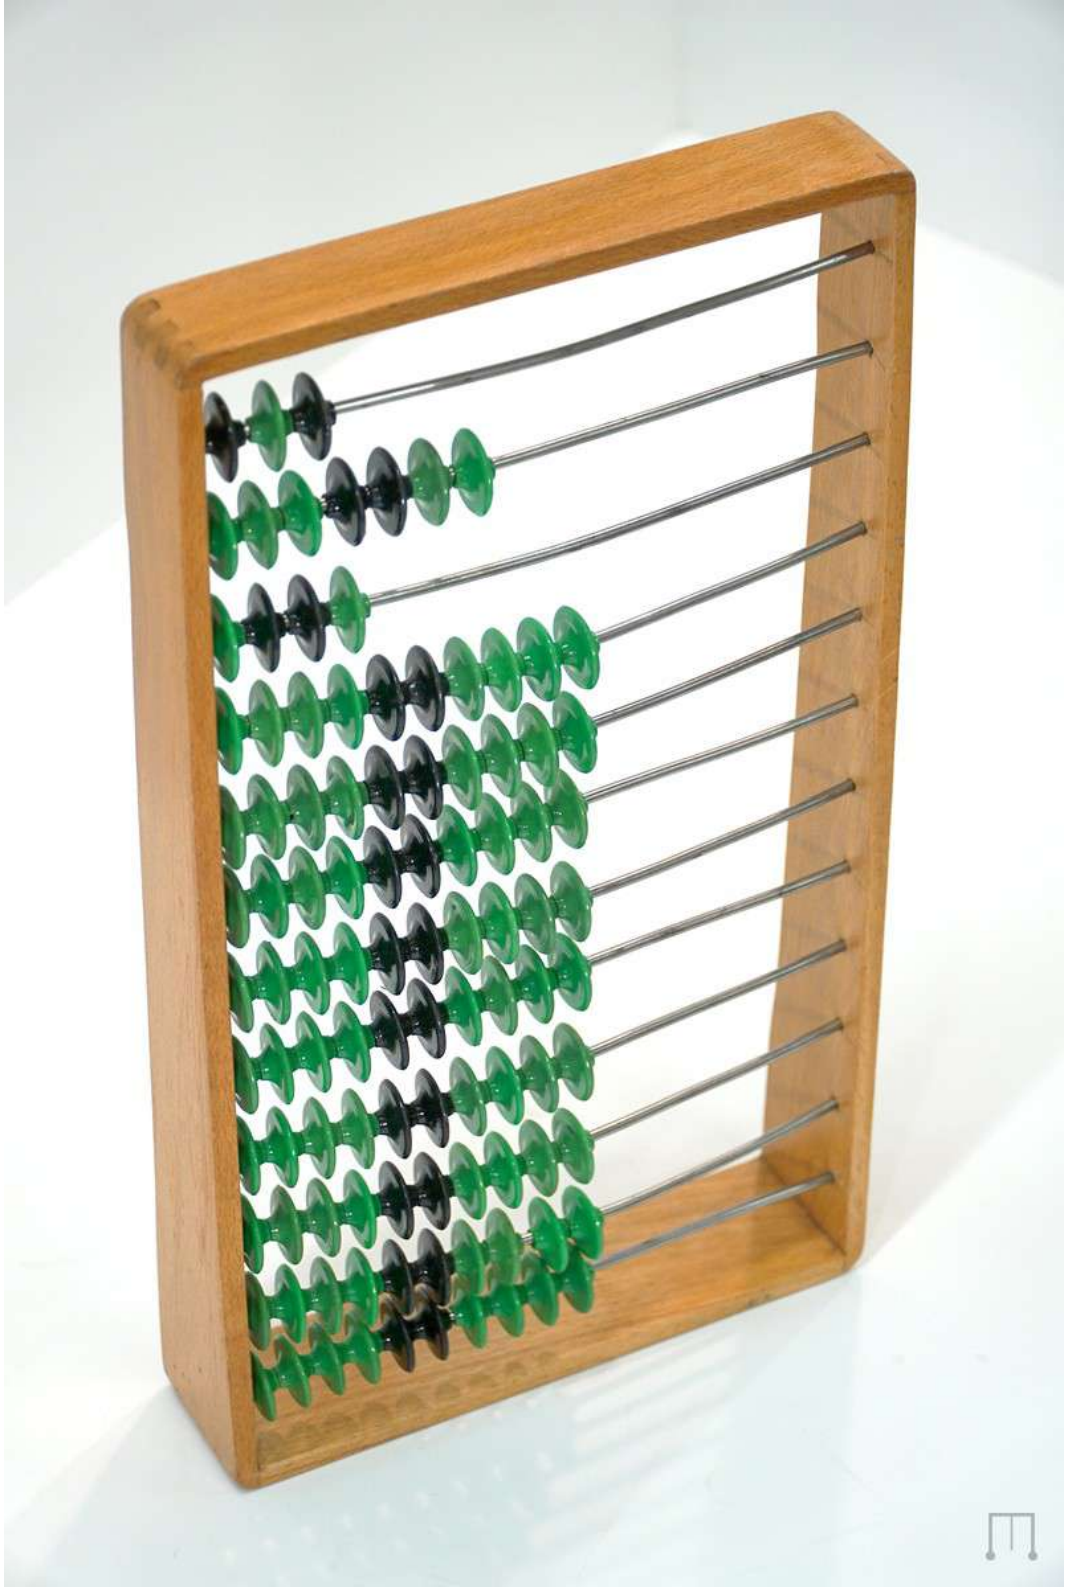


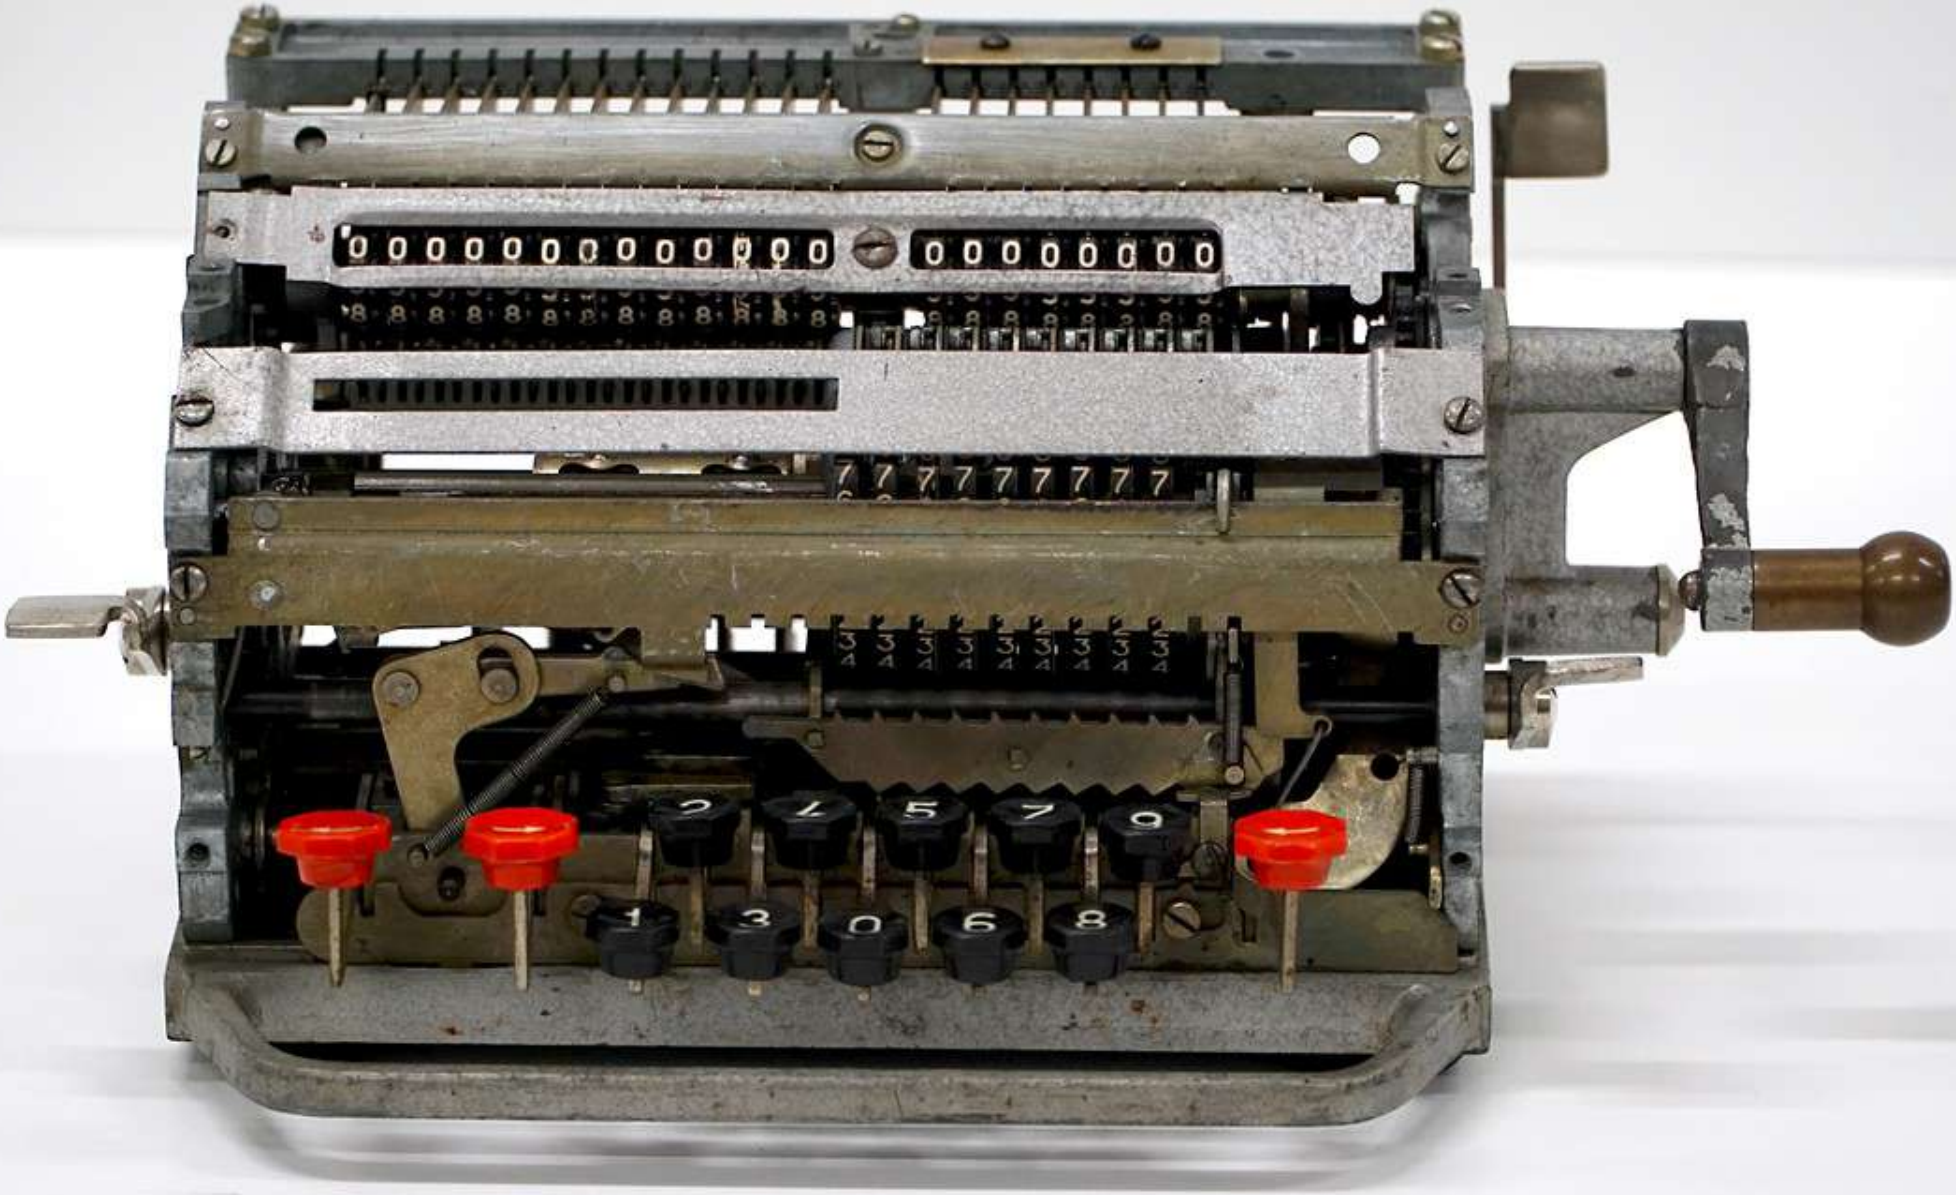
2 4 5 7 9
1 3 0 6 8


T-21/2

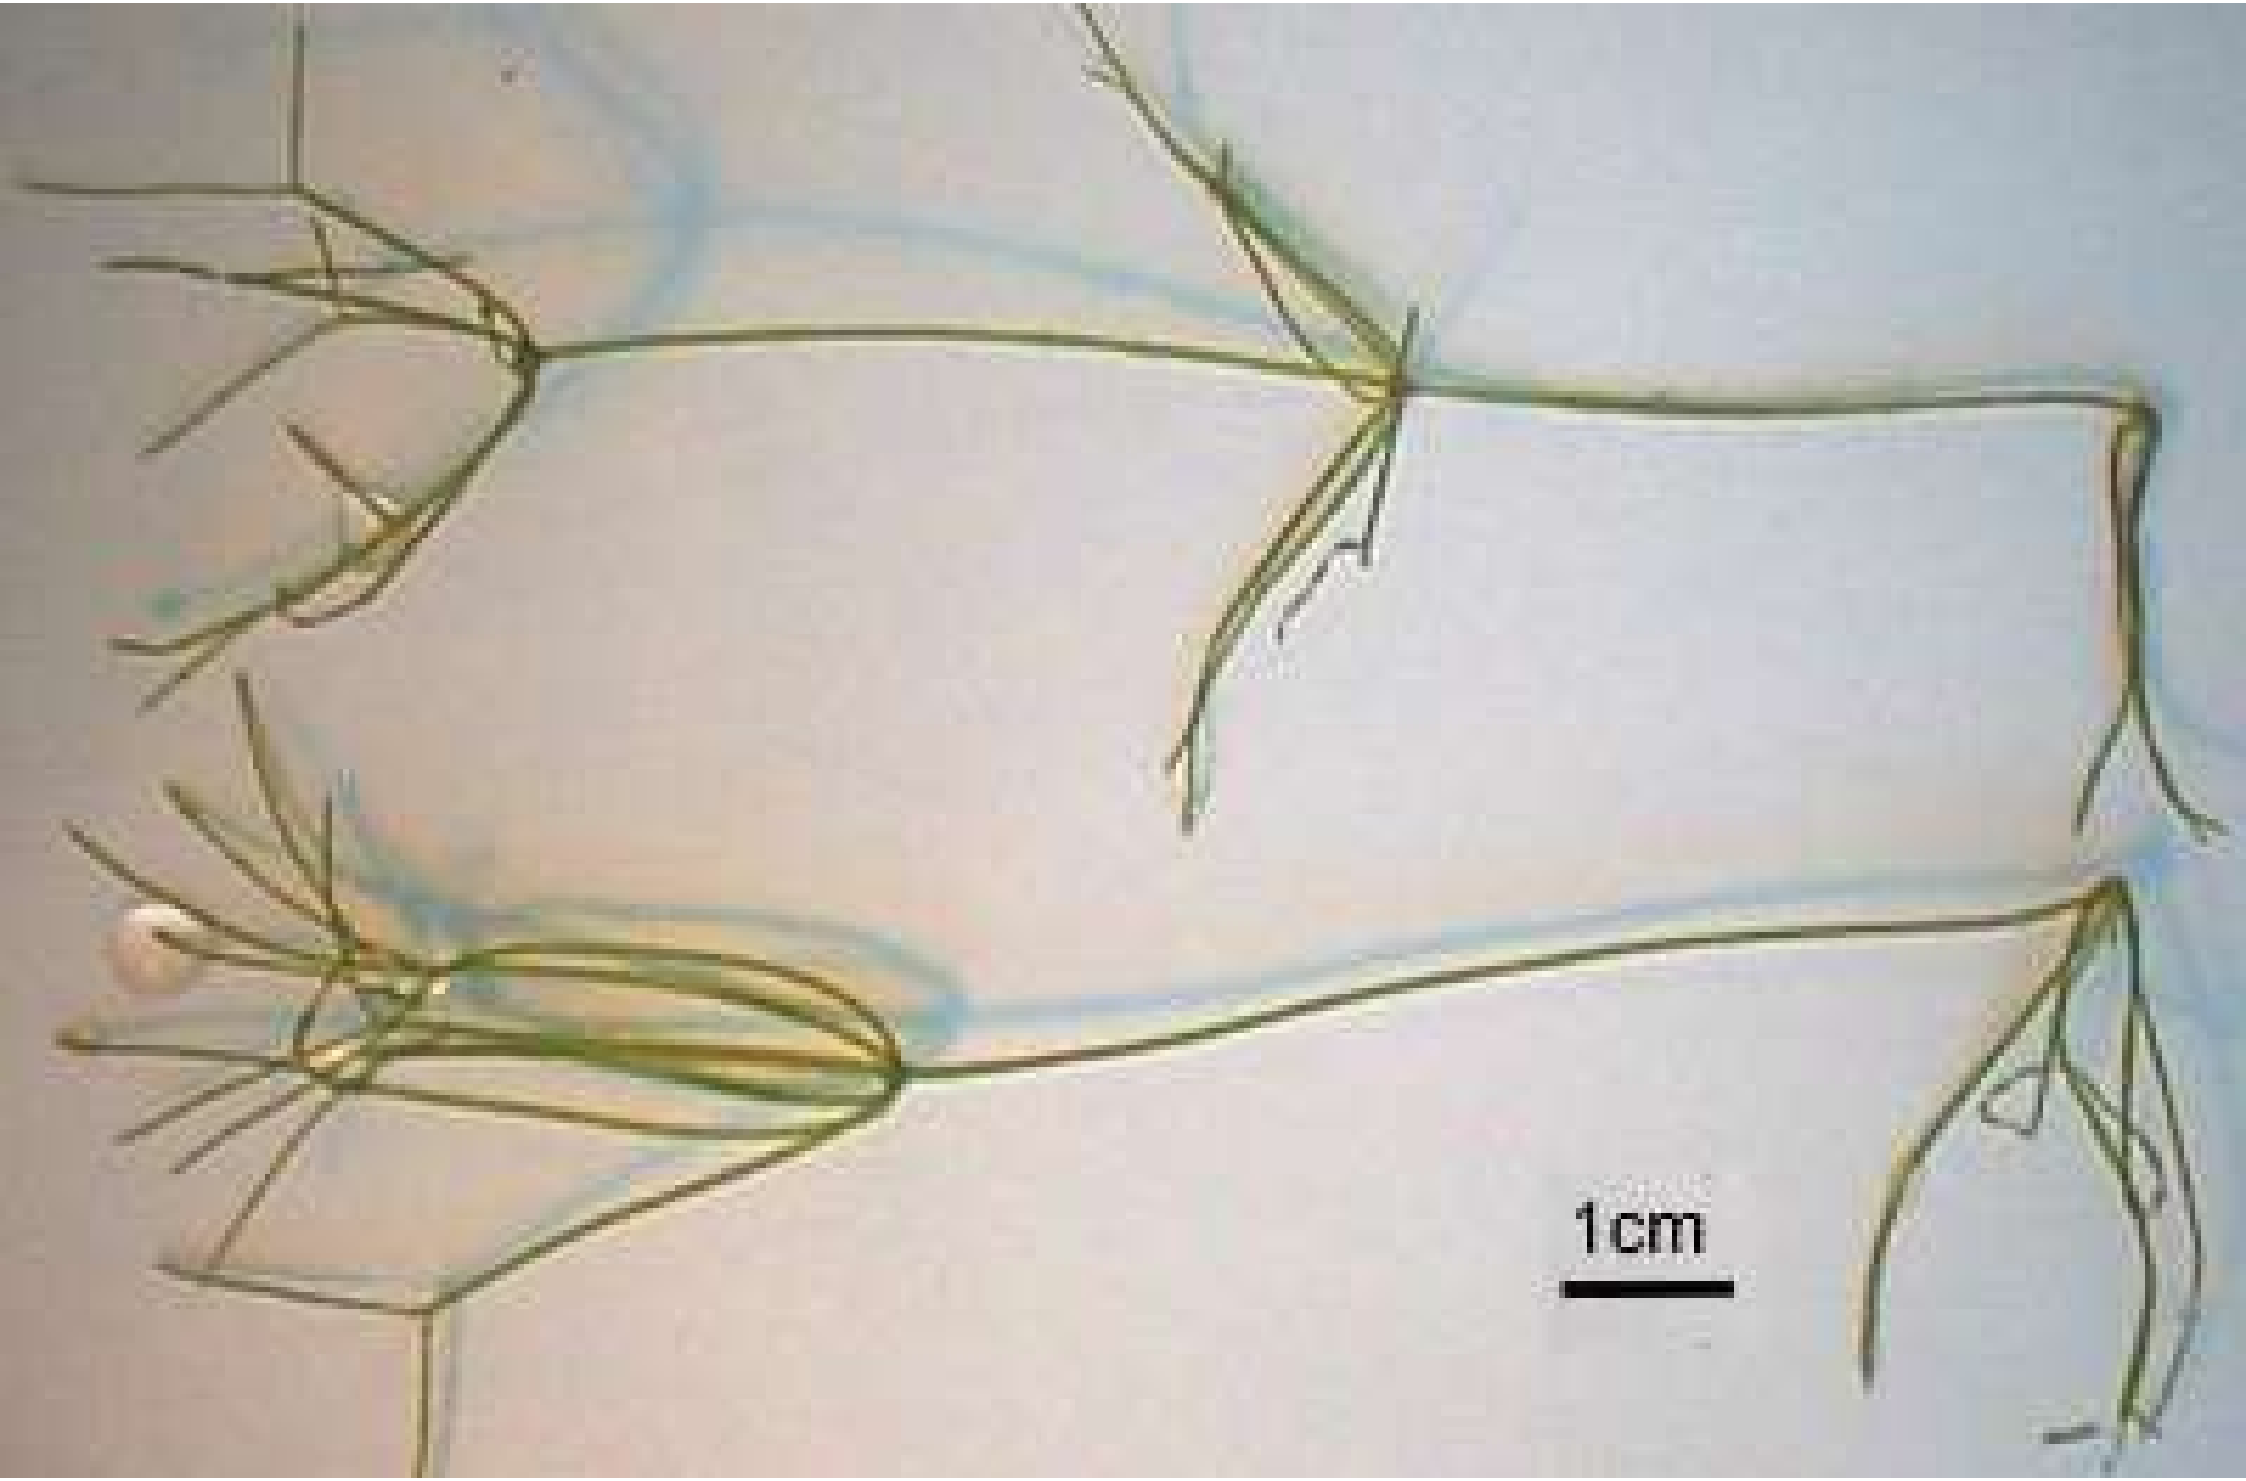



1cm

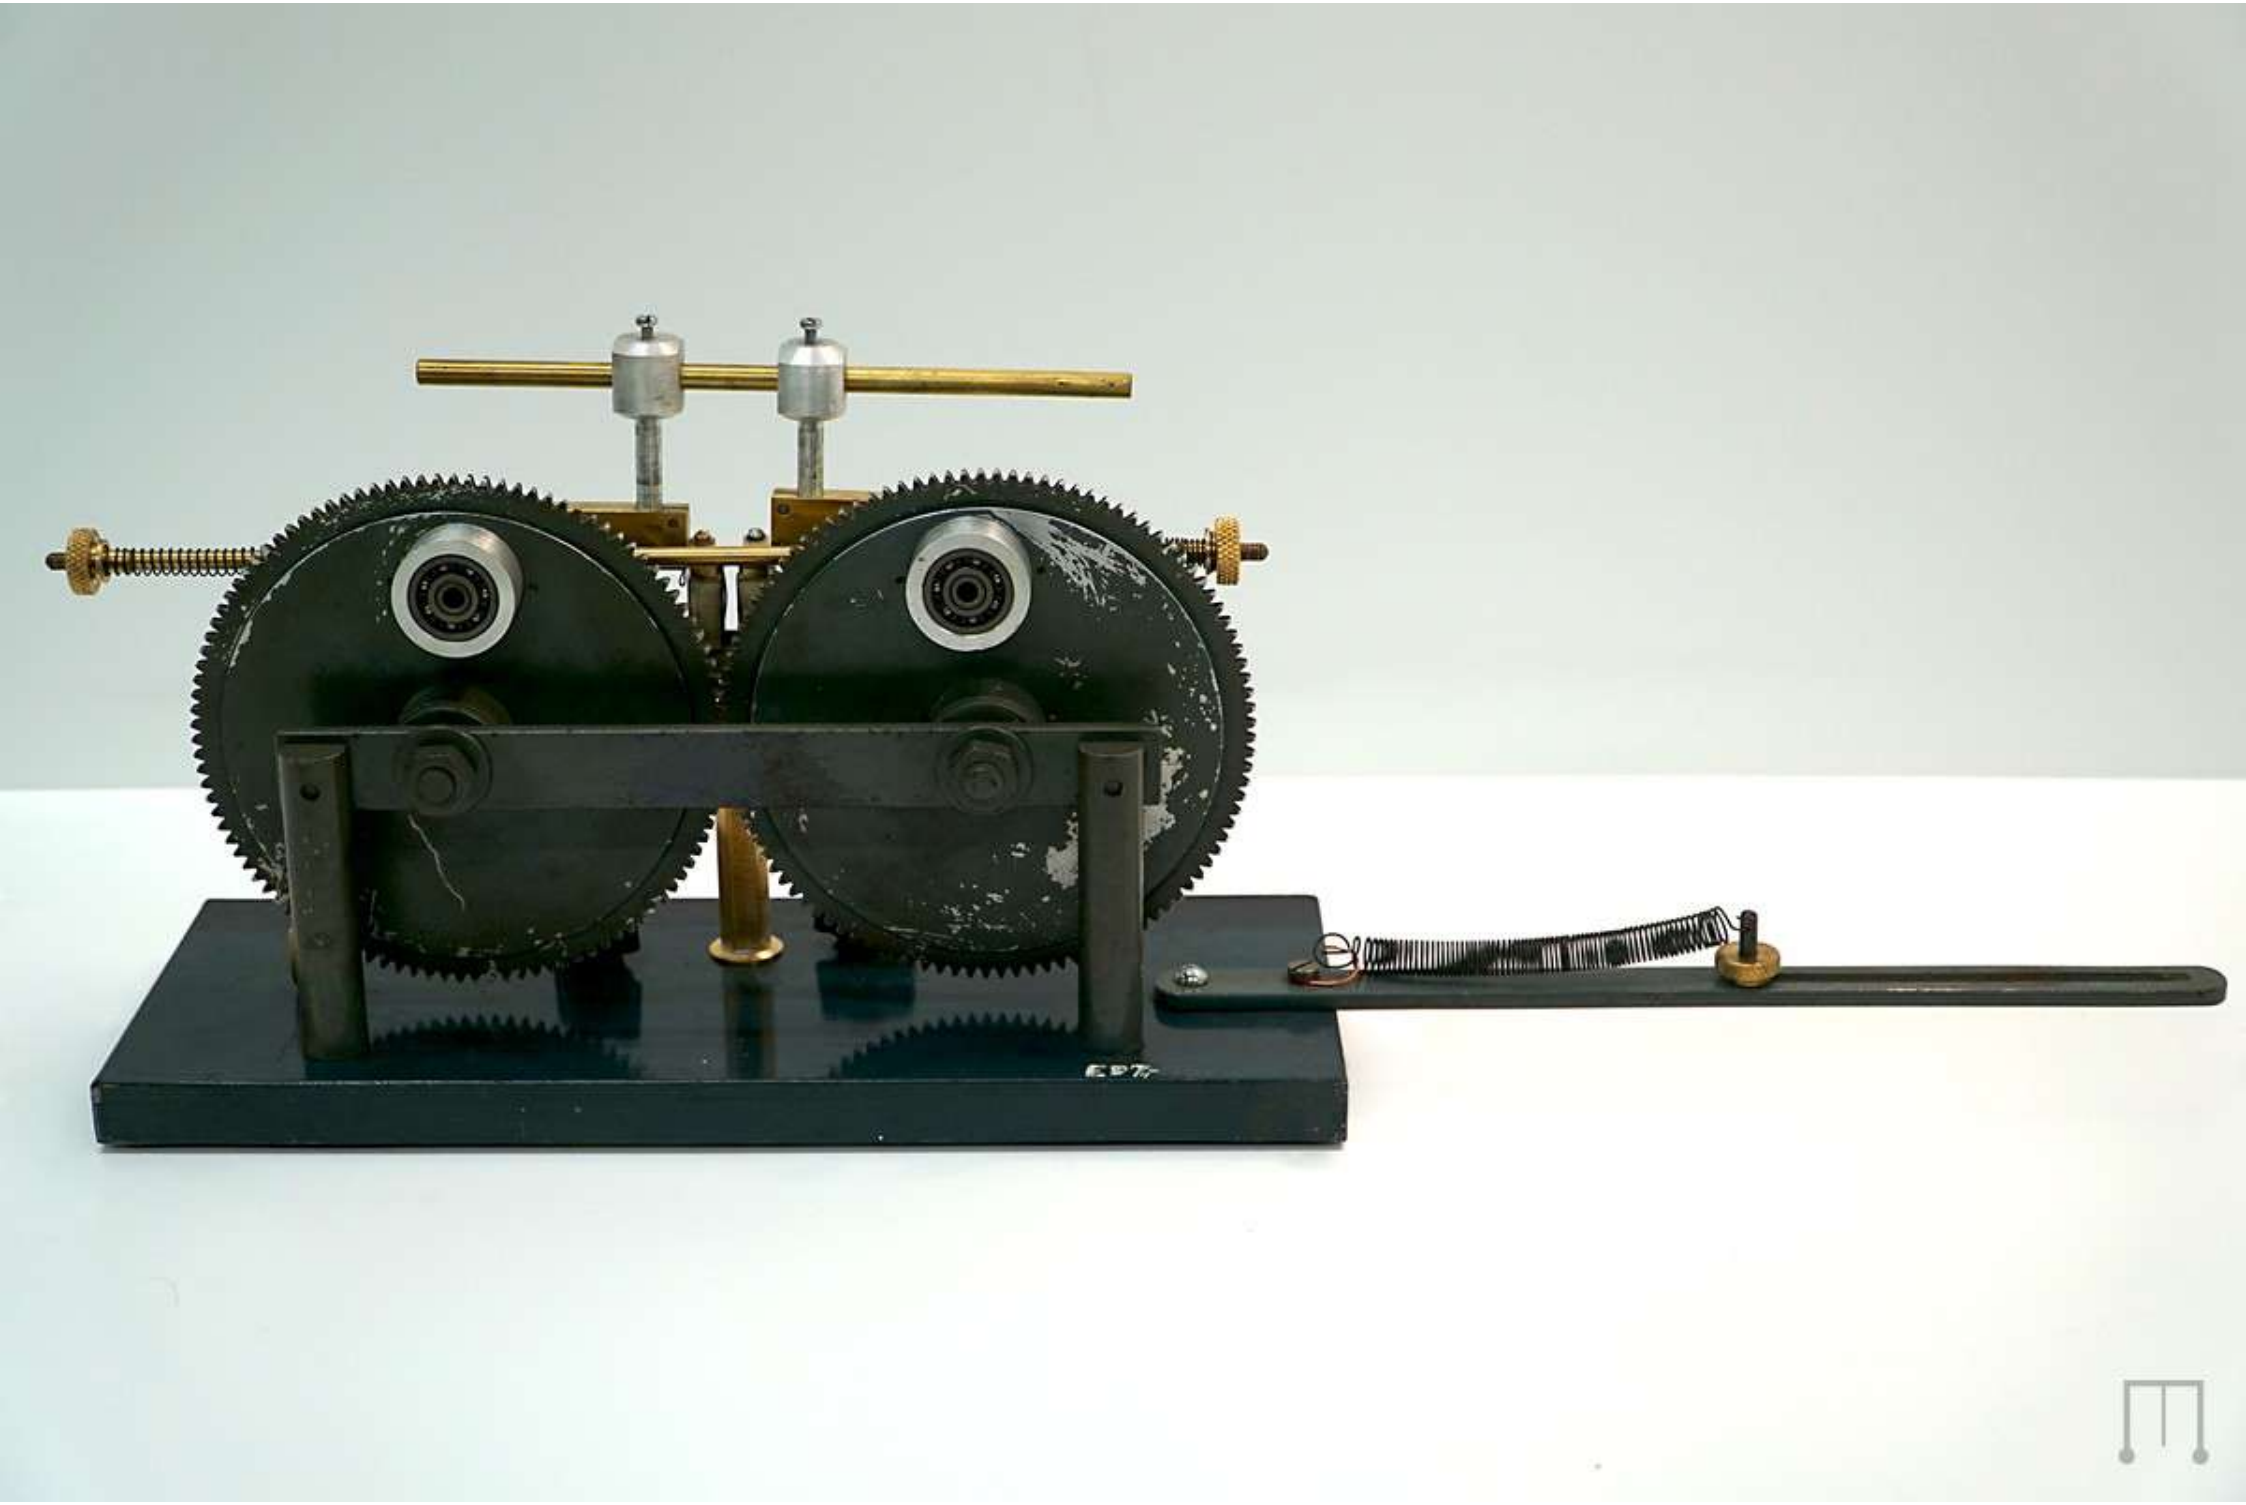


EPIQUANT




PZO
100

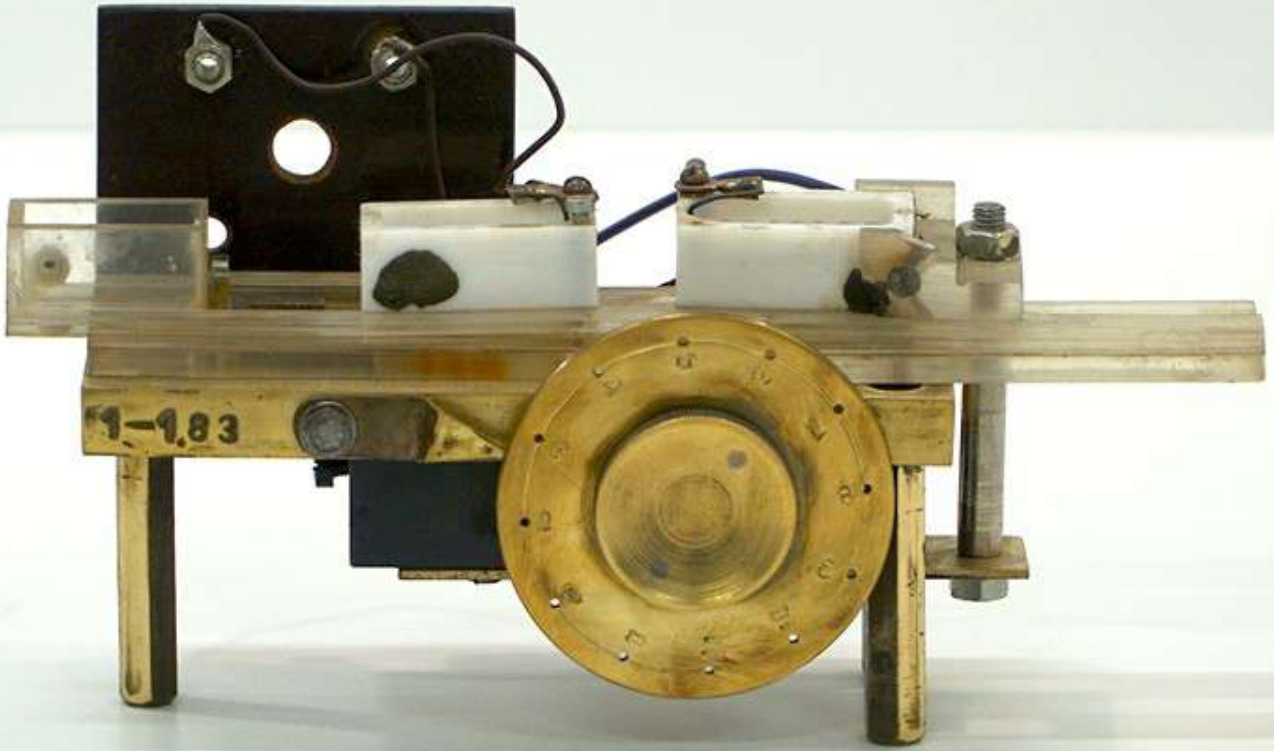

1-1.83



ALCOH
MET%






KATOMIERZ

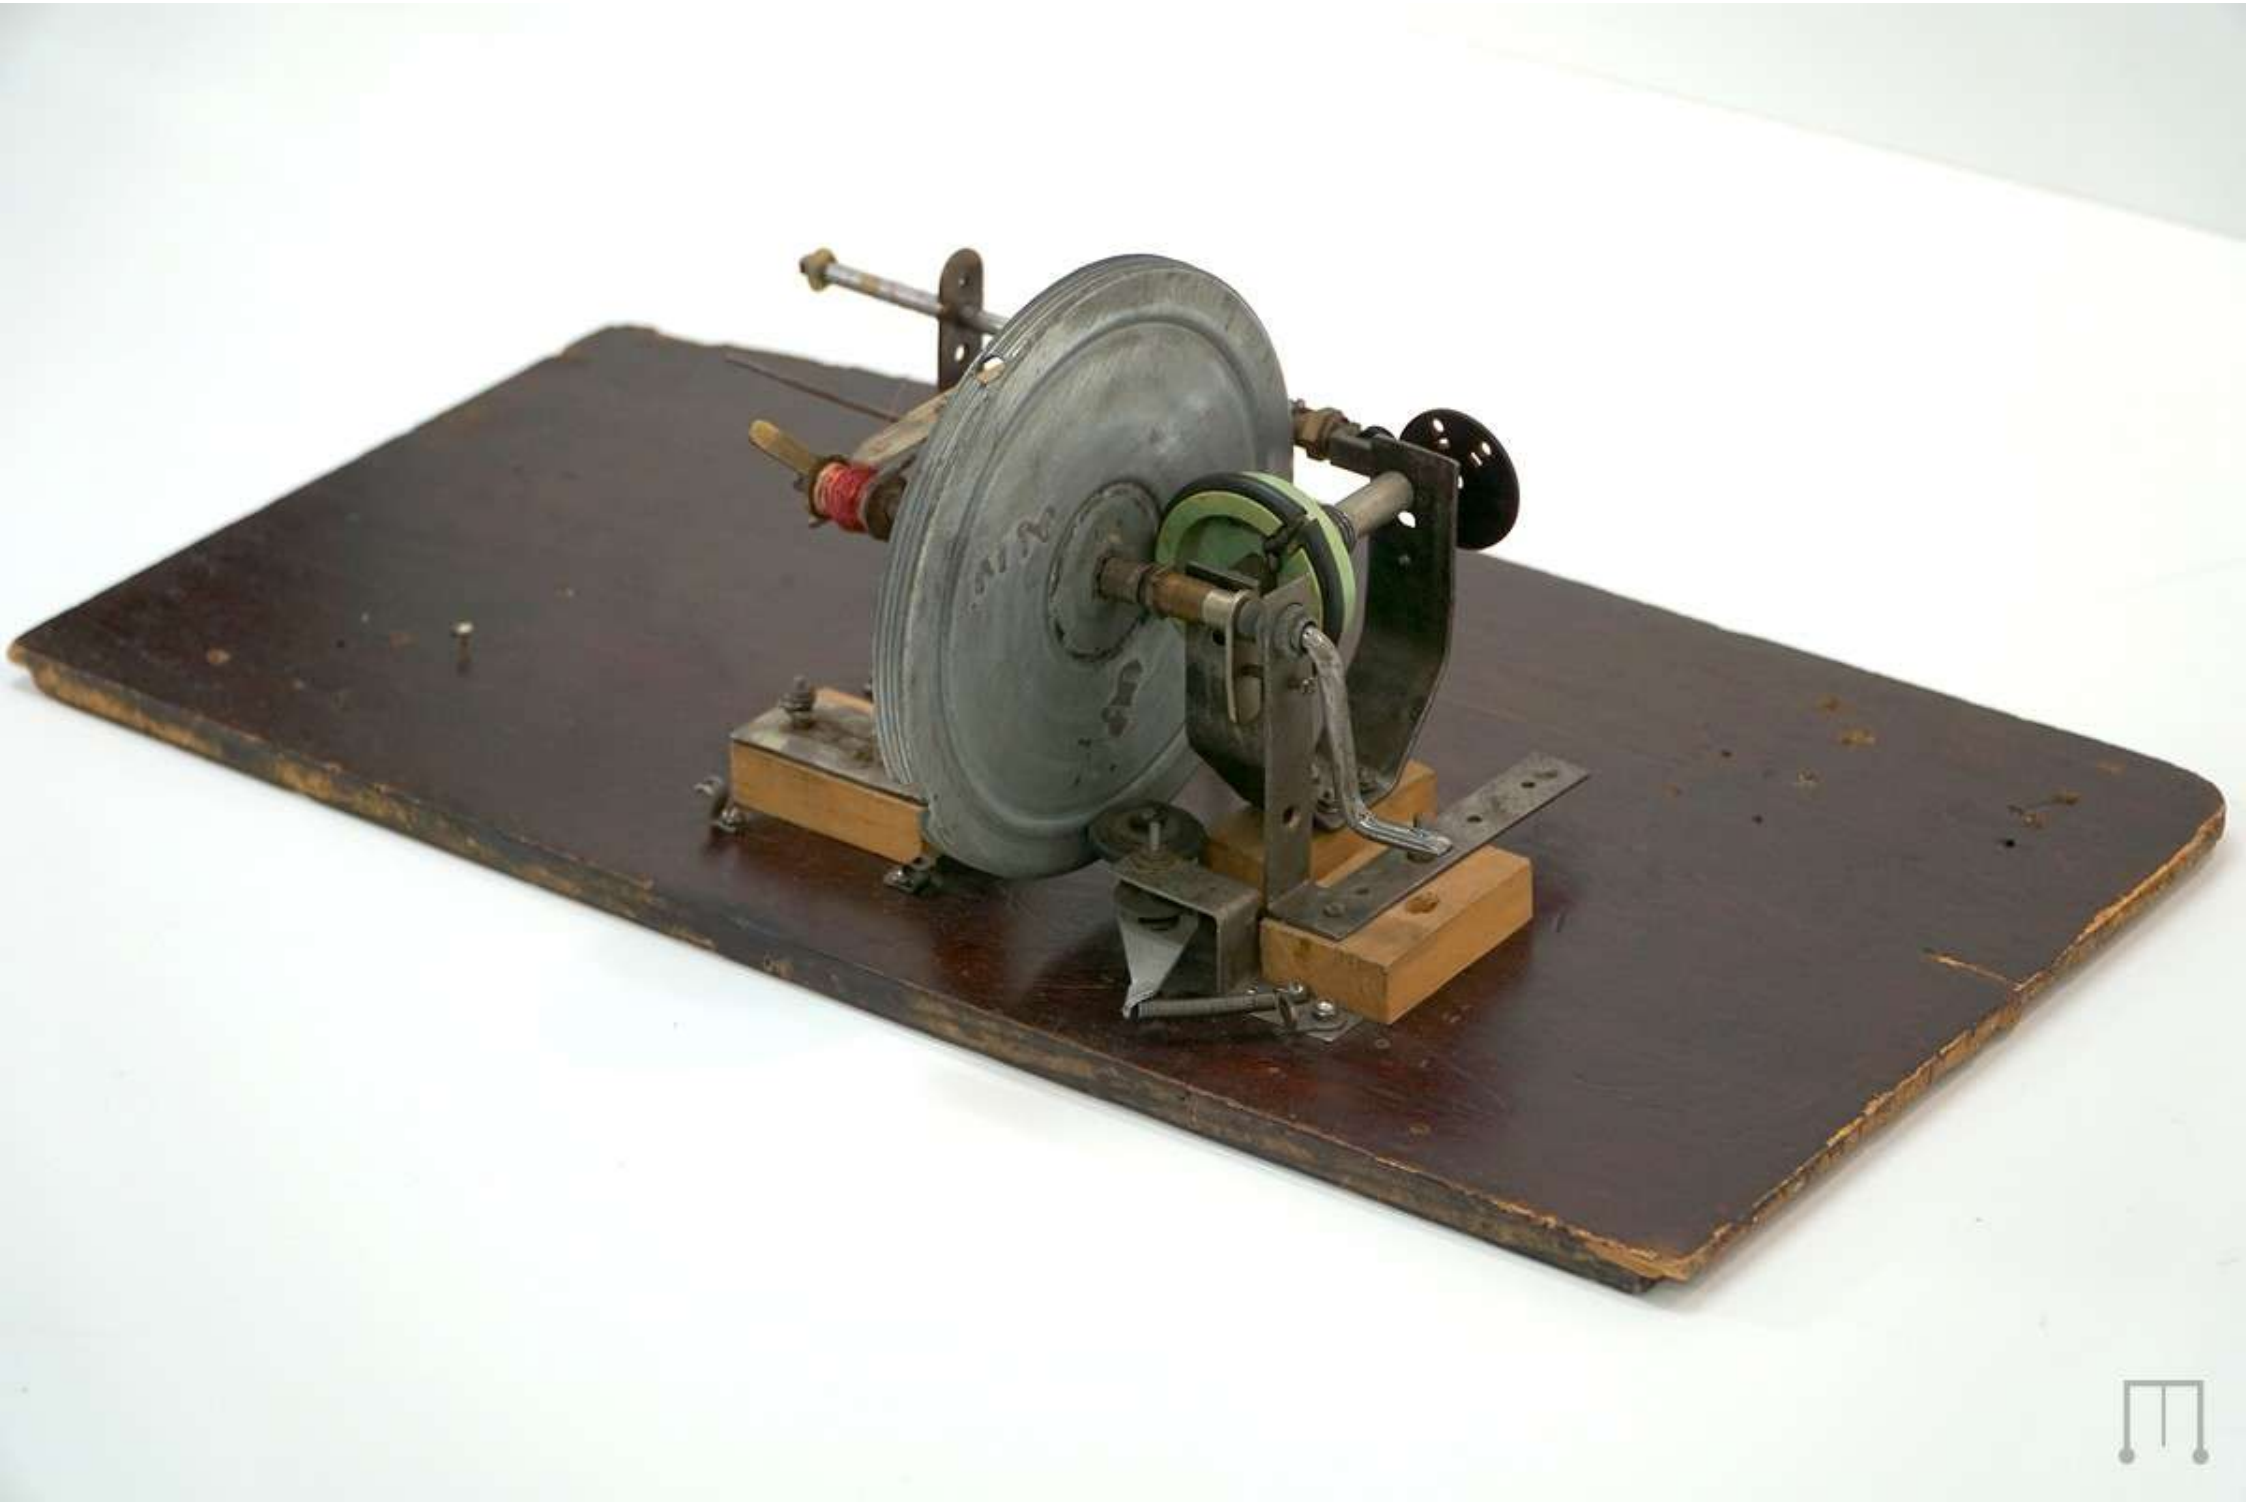

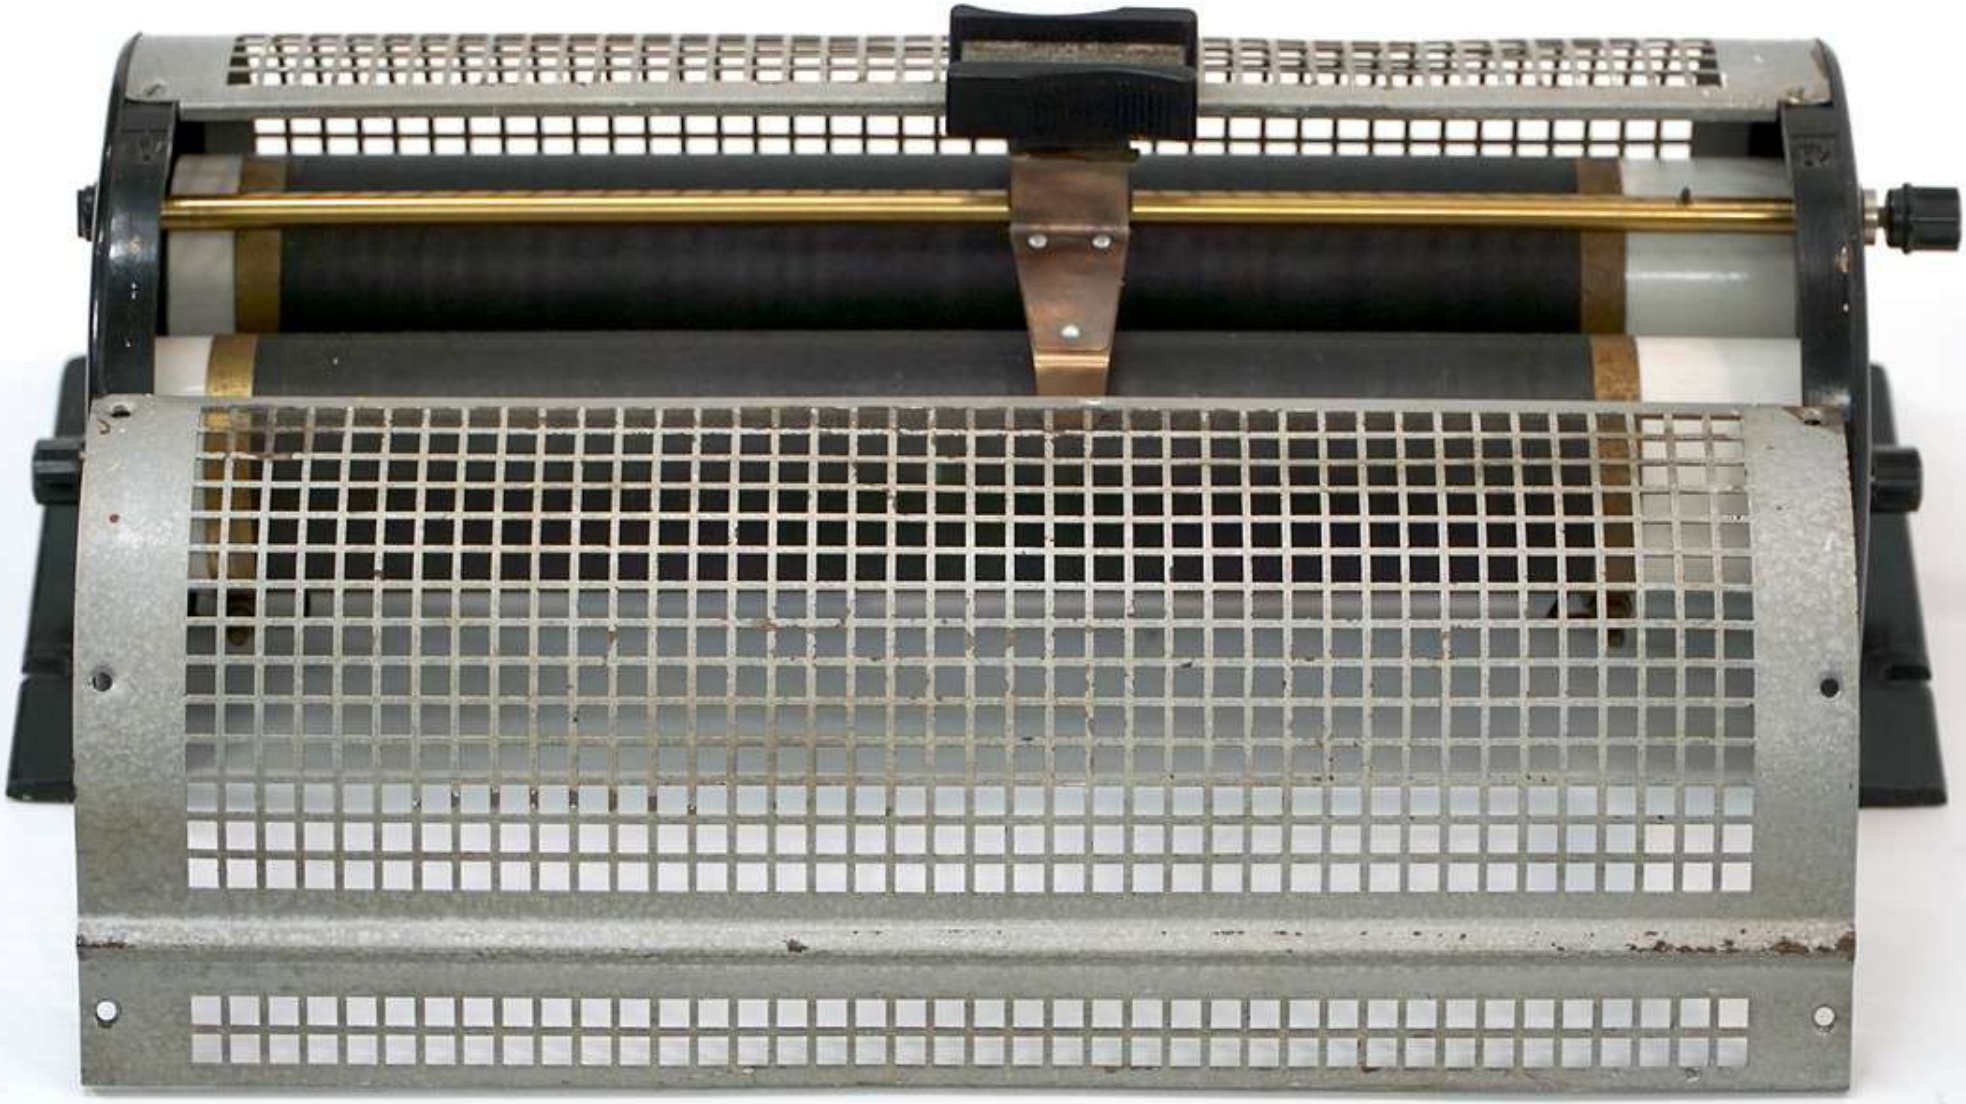



OSCILLOSCOPE OS 102
CALIBRATOR
V/CM
BEAM LOCATE
X-DISPLAY
BRILL
FOCUS
ASTIG
GRATIC
TIME/CM
SINGLE-TRACE UNIT OS 102-1
V/CM
PROBE
SYNCH
POWER ON
UNITRA ZRK




MEDA 43HA
Made in Czechoslovakia

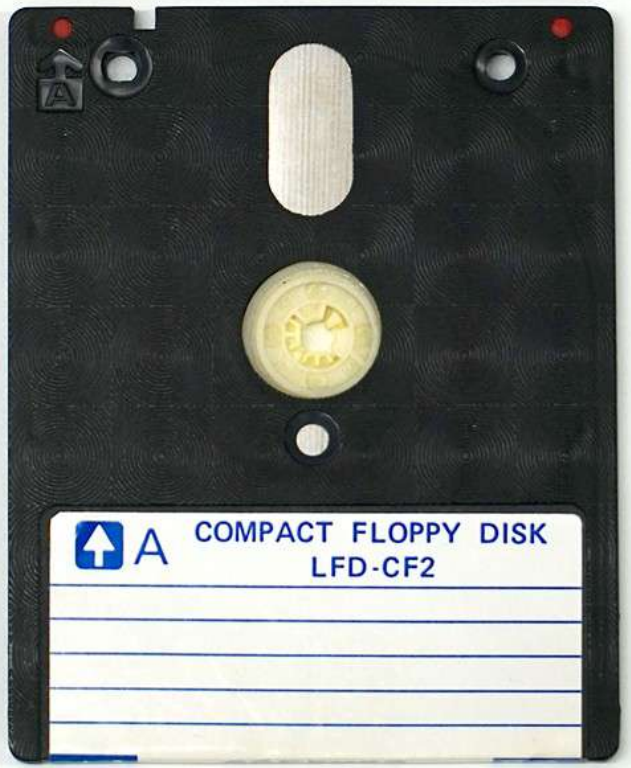


A
COMPACT FLOPPY DISK
LFD-CF2

mach. 3274 mod. 001 date 06/18/87
b/m 6016492 e/c a26741
system - config support d rel 65.1
validation number 34 BACKUP
IBM
Diskette 2
5564250
IBM 52
5
1851600520


Word 6.0
#1


020/024
BORLAND
BORLAND® C++
Copyright © 1987,1991 Borland International, Inc. All rights reserved. Licensed material — program property of Borland International, Inc. 1800 Green Hills Road, P.O. Box 660001, Scotts Valley, CA 95067-0001. Unauthorized use, duplication or distribution is strictly prohibited by federal law.
PART # 14LB-TCP02 BOR 1975
BC++ & APP. FRAMEWORKS 3.1
HIGH DENSITY
DISK 11
020/024

