

SZKŁO LABORATORYJNE	N O R M A B R A N Ż O W A	BN-87
	Szklany sprzęt laboratoryjny Nasadki do destylacji z parą wodną	6851-44/04
		Grupa katalogowa 0812

1. WSTĘP

Przedmiotem arkusza normy są wymagania dotyczące nasadek szklanych do destylacji z parą wodną, stosowanych w laboratoriach.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podział. W zależności od wielkości szlifów różni się nasadki:

NWSPW1 — z dwoma szlifami zewnętrznymi WS 19/26,

NWSPW2 — z dwoma szlifami zewnętrznymi WS 29/32.

2.2. Przykład oznaczenia nasadki do destylacji z parą wodną z dwoma szlifami zewnętrznymi WS 19/26:

NASADKA DO DESTYLACJI NWSPW1 BN-87/6851-44/04

3. WYMAGANIA

3.1. Kształt i wymiary — w mm wg rysunku.

3.2. Wykonanie. W kulce kończącej rurkę doprowadzającą parę wodną wykonać sześć otworów $\varnothing 1$ rozmieszczonych na obwodzie co 60° .


3.3. Pozostałe wymagania — wg BN-86/6851-44/01.

4. PAKOWANIE, PRZECCHOWYWANIE I TRANSPORT

Pakowanie, przechowywanie i transport — wg BN-86/6851-44/01.

5. BADANIA

Badania — wg BN-86/6851-44/01.

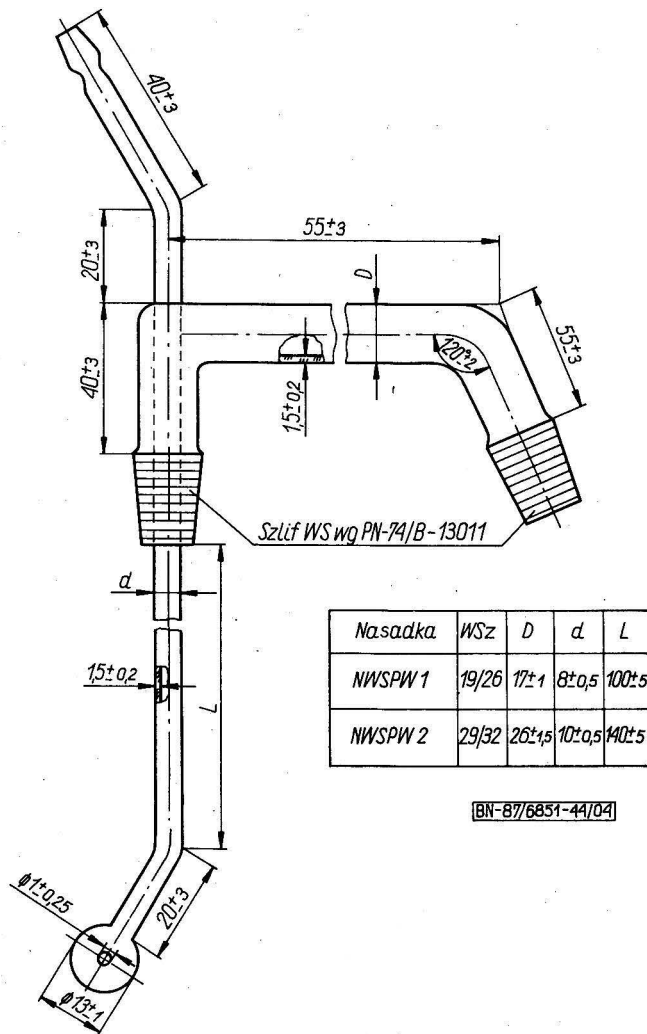

Nasadka do destylacji z parą wodną

K O N I E C

Informacje dodatkowe

Zgłoszona przez Zakład Badawczy Konstrukcyjno-Technologiczny Przetwórstwa Szkła w Poznaniu
Ustanowiona przez Prezesa Zarządu Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy dnia 17 listopada 1987 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1988 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 2/1988, poz. 4)

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Krajowy Związek Spółdzielni Sprzętu Medycznego i Laboratoryjnego, Zakład Badawczy Konstrukcyjno-Technologiczny Przetwórstwa Szkła, Poznań.

2. Normy związane
BN-86/6851-44/01 Szklany sprzęt laboratoryjny. Nasadki do destylacji. Ogólne wymagania

3. Symbol wg SWW — 1522-24.

4. Autor projektu normy — Bogumiła Krzyszkowiak — Zakład Badawczy Konstrukcyjno-Technologiczny Przetwórstwa Szkła, Poznań.