

SZKŁO LABORATORYJNE	NORMA BRANŻOWA	BN-87
	Szklany sprzęt laboratoryjny Nasadki do destylacji próżniowej	6851-44/05
		Grupa katalogowa 0812

1. WSTĘP

Przedmiotem arkusza normy są wymagania dotyczące nasadek szklanych do destylacji próżniowej, stosowanych w laboratoriach.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podział. W zależności od wielkości i kształtu rozróżnia się nasadki:

NWSPP1 — ze szlifem wewnętrznym i zewnętrznym WS 19/26 oraz prostym wkraplaczem pomiarowym pojemności 50 cm³,

NWSPP2 — ze szlifem wewnętrznym i zewnętrznym WS 29/32 oraz prostym wkraplaczem pomiarowym pojemności 100 cm³,

NWSPZ1 — ze szlifem wewnętrznym i zewnętrznym WS 19/26 oraz zgiętym pod $\angle 105^\circ$ wkraplaczem pomiarowym pojemności 50 cm³,


NWSPZ2 — ze szlifem wewnętrznym i zewnętrznym WS 29/32 oraz zgiętym pod $\angle 105^\circ$ wkraplaczem pomiarowym pojemności 100 cm³.

2.2. Przykład oznaczenia nasadki do destylacji próżniowej ze szlifem wewnętrznym i zewnętrznym WS 19/26 oraz prostym wkraplaczem pomiarowym pojemności 50 cm³:

NASADKA DO DESTYLACJI NWSPP1 BN-87/6851-44/05

3. WYMAGANIA

3.1. Kształt i wymiary — w mm wg rys. 1 i 2 oraz tablicy.

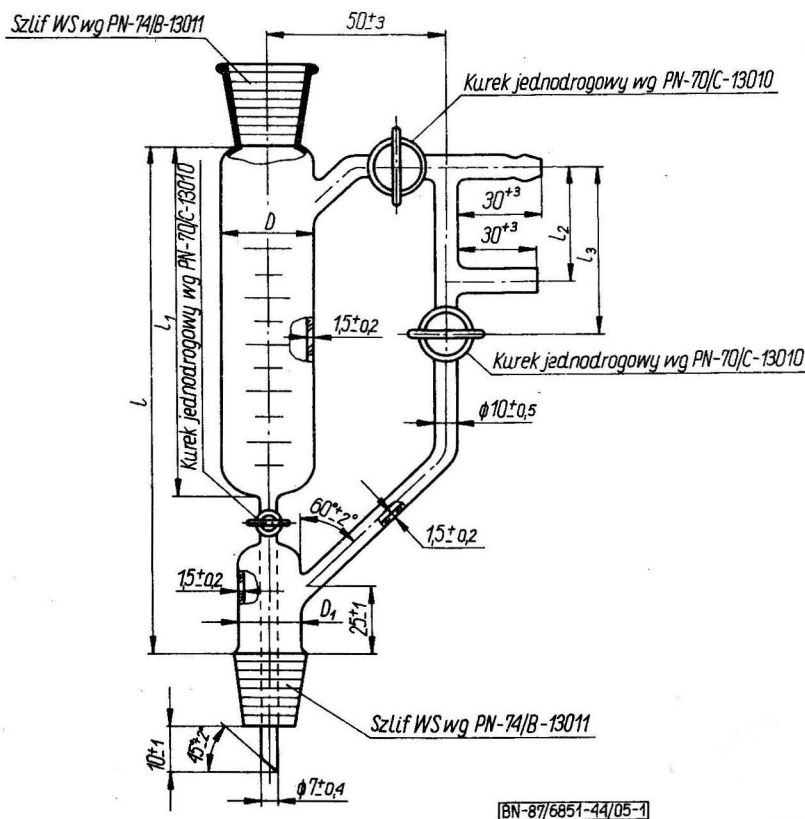

Rys. 1. Nasadka do destylacji próżniowej z prostym wkraplaczem pomiarowym

Zgłoszona przez Zakład Badawczy Konstrukcyjno-Technologiczny Przetwórstwa Szkła w Poznaniu
Ustanowiona przez Prezesa Zarządu Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy dnia 17 listopada 1987 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1988 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 2/1988, poz. 4)

- 4. Autor projektu normy** — Bogumiła Krzyszkowiak — Zakład Badawczy Konstrukcyjno-Technologiczny Przetwórstwa Szkła, Poznań.