

SPRZĘT DO POMIARU TEMPERATURY	NORMA BRANŻOWA	BN-82
	Termometry szklane Termometry do aparatów wylęgowych Termometr kątowy do kwoki elektrycznej typ EK 600	5531-32.02
		Grupa katalogowa 1321

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest termometr kątowy do pomiaru temperatury w kwoce elektrycznej, która przeznaczona jest do chowu kurcząt od pierwszego dnia do 4 ± 7 tygodni.

2. Przykład oznaczenia termometru kąowego (IK) do kwoki elektrycznej (EK 600) o zakresie pomiarowym od +18 °C do +35 °C, działce elementarnej 0,5 °C:


TERMOMETR DO KWOKI ELEKTRYCZNEJ - IK - EK 600
BN-82/5531-32.02

3. Wymagania metrologiczne - wg tabl. 1 i BN-81/5531-32.00.

Tablica 1

Wymagania	
1	2
a) Zakres pomiarowy, °C	+18 ÷ +35
b) Wartość działki elementarnej °C	0,5
c) Punkty sprawdzania, °C	+18; +25; +35

4. Wymagania konstrukcyjne - wg rys. 1, tabl.2 i BN-81/5531-32.00.

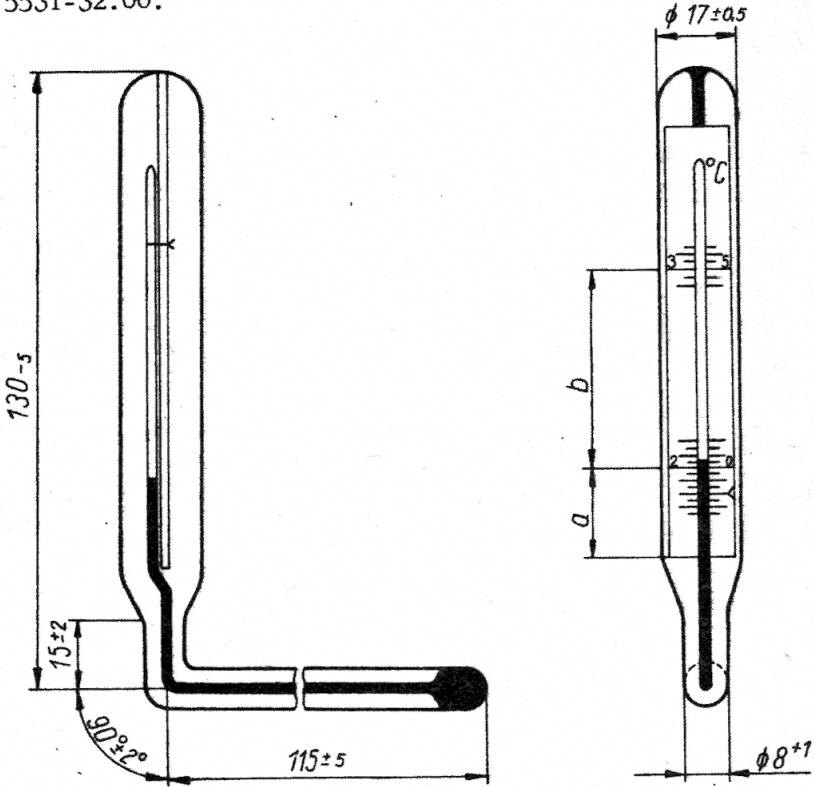

Rys. 1

Zgłoszona przez Zakład Badawczy Konstrukcyjno-Technologiczny Przetwórstwa Szkła w Poznaniu
Ustanowiona przez Prezesa Zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Sprzętu Medycznego i Laboratoryjnego
dnia 24 lutego 1982 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1982 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 7/1982 poz. 16)

Tablica 2

Wymiar	Podzielnia ze szkła mlecznego	Podzielnia papierowa
a	20 ±2	15 ±5
b	40 ±5	35 ±5

5. Materialy - wg BN-81/5531-32.00.


6. Wykonanie - wg - BN-81/5531-32.00 i rys. 2.

7. Napisy - wg BN-81/5531-32.00.

8. Wyróżnienie kreski 18 °C. Kreskę podziałki wskazującej temperaturę 18 °C należy wyróżnić znakiem < koloru czerwonego.

9. Opakowanie jednostkowe. Każdy termometr powinien być opakowany w miękki papier.

10. Pozostałe wymagania - wg BN-81/5531-32.00.

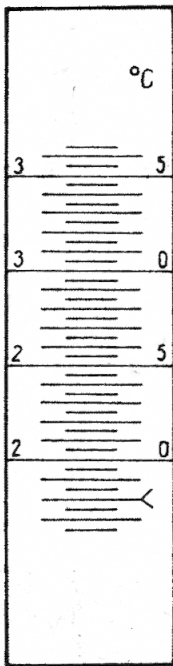

Rys. 2

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Zakład Badawczy Konstrukcyjno-Technologiczny - Branżowy Ośrodek Normalizacji. Poznań.

2. Normy związane
BN-81/5531-32.00 Termometry szklane. Termometry do aparatów wylęgowych. Wspólne wymagania i badania

3. Dotychczas ustanowione arkusze normy
BN-81/5531-32.00 Termometry szklane. Termometry do aparatów wylęgowych. Wspólne wymagania i badania
BN-82/5531-32.01 Termometry szklane. Termometry do aparatów wylęgowych. Termometr kątowy do aparatu wylęgowego typ KU 102

4. Symbol wg SWW - 0945-219.